

科学的眼睛

The Eyes Of Science

严谨 科学

Rigorous Science

质量的标尺

The Scale Of Quality

客观 公正

Objective Justice

检测报告

TEST REPORT

第1页, 共3页

报告编号 : 1807-6-456-1

Report No.

委托单位 : 新和金属制品厂有限公司

Applicant

检测类别 : 送检

Check categories

实验室地址 : 佛山市南海区大沥体育路20号 (大沥意交警中队旁)

Laboratory Add:NO.20,Tiyu Road ,Dali,Nanhai District,
Foshan, Guangdong, China

电话Tel: 0757-85559898(业务受理)Business Acceptance

0757-85553987(报告查询)Report Query

传真Fax:0757-85553177

网址 : www.jmtlab.com

E-mail:jmt@jmtlab.com



佛山市精美检测技术有限公司
Foshan Jingmei Testing Technology CO., Ltd



精美检测技术有限公司
检测报告

TEST REPORT

报告编号(Report No.): 1807-6-456-1

第 2 页 共 3 页

委托单位 : 新和金属制品厂有限公司
委托单位地址 : /

样品名称 : PP 塑料
收样日期 : 2018.07.06
检测要求 : 样品做主成分分析
检测日期 : 2018.07.07-2018.07.11
报告日期 : 2018.07.12
检测结果 : 见于下一页



- 声明:
- 1: 检测结果仅对来样负责, 样品保留至收样后 30 天。
 - 2: 检测报告盖章有效, 报告部分复印无效。
 - 3: 若对检测结果有异议, 请于收到结果之日起 15 天内向本公司提出。

单位盖章:

批准:

审核:

测试:

检测报告


TEST REPORT



报告编号(Report No.): 1807-6-456-1

第 3 页 共 3 页

样品描述 : PP 塑料
检测标准 : GB/T6040-2002
检测仪器 : FTIR
样品测试结果 : 见于下方

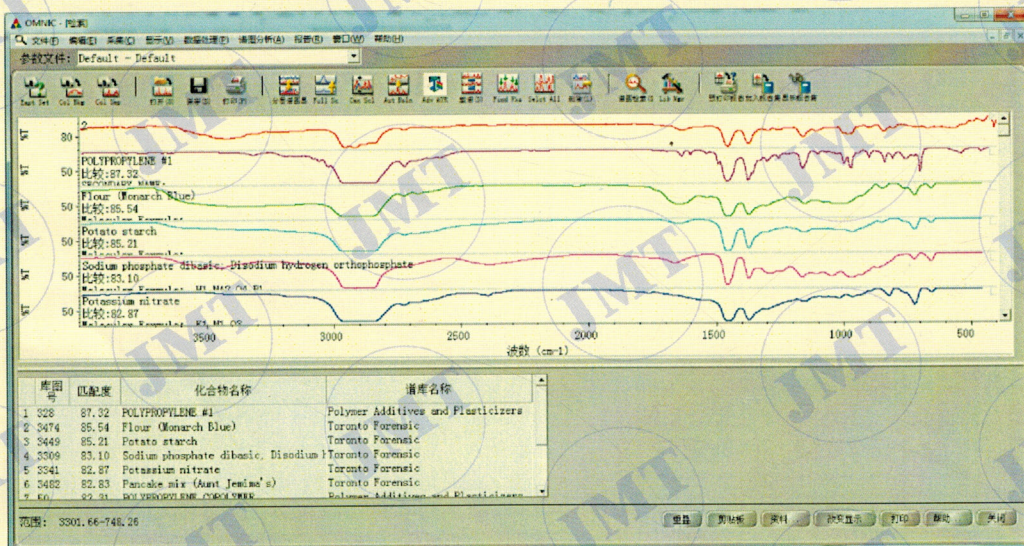

PP 塑料样品红外谱图与聚丙烯标准红外谱图的匹配图

结果说明: PP 塑料样品红外谱图与聚丙烯标准红外谱图的匹配值为 87.32, 样品主成分为 PP 塑料。

*****报告结束*****